

**Bijlagen bij
Deel A: KEW-deel**

Revisie van Bijlage A17:

**Afschermingsberekeningen
Röntgentoestellen**

Revisie 11/03/2015

Revisieoverzicht

Wijzigingsdatum

11/03/2015

Aanleiding van de wijzigingen

Sinds de op 16 juni 2013 toegekende Kew vergunning heeft HollandPTC voor andere leverancier van protonenapparatuur gekozen dan eerder was voorzien. Dit heeft veranderingen tot gevolg in de technische specificaties van het cyclotron en op detailniveau in het gebouwontwerp. Om deze reden is een aantal bijlagen bij Deel A van de meest recente vergunningsaanvraag gereviseerd. Hierbij zijn niet alleen de nieuwste specificaties en inzichten meegenomen maar is ook de leesbaarheid van de bijlagen verbeterd. Om de consistentie tussen de bijlagen onderling te bewaren, betekent dit dat een wijziging nodig is in deze bijlage.

Samenvatting van de wijzigingen

In andere bijlagen is de term "doeldosis" vervangen door "operationele grenswaarde" om te benadrukken dat het geen "doel" is om deze dosis te bereiken. Integendeel, de werkelijke dosis zal beneden deze waarde (moeten) blijven. In Bijlage A17 is genoemde aanpassing van de term daarom ook doorgevoerd. De inhoud is verder onveranderd.

Conclusie van de wijzigingen

Er is geen sprake van een inhoudelijke wijziging. Wel wordt gevraagd Bijlage A17 zoals genoemd in de vigerende vergunning te vervangen door deze gewijzigde bijlage als beschrijving van de handelingen (**vergunning V, onder L, onder 1**).


Afschermingsberekeningen CT

Deze bijlage heeft betrekking op de aanvraag van vier CT-scanners voor klinisch gebruik van beeldvorming binnen HollandPTC. Belangrijk algemene feiten zijn:

- Het imaging block van HollandPTC is zeer waarschijnlijk niet de definitieve layout van dit blok. Exacte locaties en afmetingen van ruimtes worden nog afgestemd.
- Voor alle CT-scanners beschreven in deze bijlage geldt dat de leverancier en het exacte type nog gekozen moeten worden. Ook de precieze locatie van de scanners in de betreffende ruimtes is nog niet exact bekend. Berekeningen in deze bijlage zijn dan ook indicatief, met de **operationele grenswaarde** als belangrijkste gegeven.
- Voor alle CT scanners is gerekend met een **operationele grenswaarde van 0.1 mSv** per jaar op enig punt buiten de ruimte waar de CT-scanner staat.
- Voor de afschermingsberekeningen van alle CT-scanners is gebruik gemaakt van de door Philips aangeleverde dosis map van hun Brilliance Big Bore CT. Deze is enkele jaren geleden geinstalleerd bij het LUMC, een van de klinische partners van HollandPTC.
- De vloerdiktes van het imaging blok naar de eerste verdieping zijn 30 cm beton.

CT-scanner en verstrooiingsprofielen:

De effectieve dosis ten gevolg van de secundaire straling bij gebruik van de Philips Brilliance Big Bore CT is gegeven door de fabrikant voor de maximale buisspanning van 140 kV (zie figuur 1). Aangezien het typische radiologische onderzoek met 125 kV plaats vindt, leidt dit tot een overschatting van de benodigde afscherming.

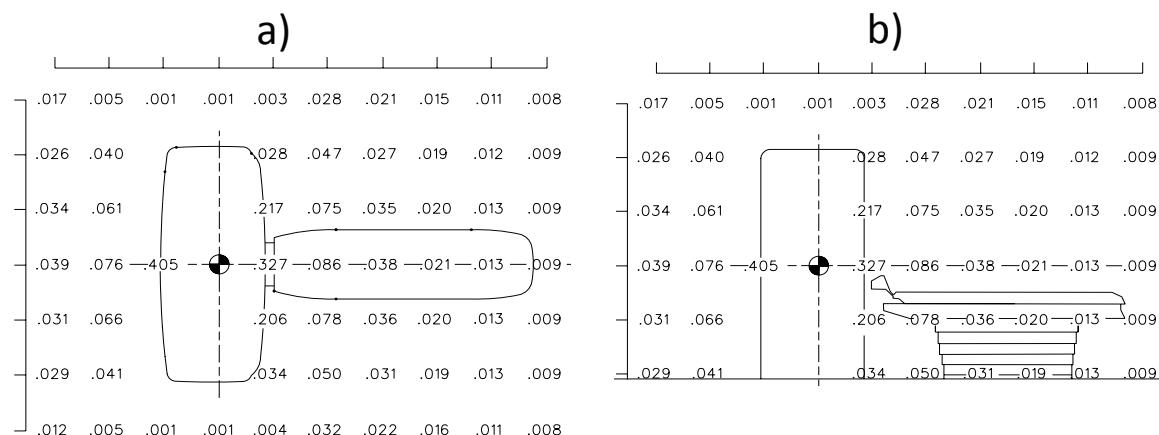

Figuur 1: Strooistralingsmappen in a) het horizontale en b) verticale vlak voor de Philips Brilliance Big Bore CT. Data in $\mu\text{Sv}/\text{mAs}$, voor een buisspanning van 140 kV en een maximale collimatoropening van $16 \times 1.5 = 24 \text{ mm}$. Een standaard CTDI body-fantoom, met een diameter van 32 cm en een lengte van 15 cm, is hiervoor gebruikt.

De effectieve dosis op grotere afstand dan gegeven in figuur 1 is met behulp van de kwadratenwet geschaald, met de waarde op en afstand tot de rand van de figuur als referentie voor extrapolatie.

Halfwaardedikten

Sutton en Williams geven [ref 1] een empirische formule (4.1) waarmee de transmissie van X-rays door (afschermbare) materiaal berekend kan worden voor een brede bundel geometrie. De parameters (α , β , γ) voor secundaire straling worden voor meerdere materialen gegeven in [ref 2], tabel A.1. Voor deze berekeningen gebruiken we de parameters voor 150 kV. Dit leidt tot een overschatting van de equivalente dosis achter het afschermbare materiaal, aangezien de typische hoogspanning voor radiodiagnostiek minder dan 125 kV is.

Doel van de berekeningen in deze bijlage is om voor ieder punt de minimum afschermdikte in millimeters lood te bepalen voldaan wordt aan de eis om onder de **operationele grenswaarde** (van 0.1 mSv) te blijven. In de uiteindelijke situatie kan de afscherming met lood plaatsvinden, of met een equivalente dikte van beton of enig ander materiaal. Voor de volledigheid is per CT-scanner en per berekeningspunt ook de equivalente dikte van beton gegeven.

Het gebruik van de halfwaardedikte (HVL) van $\ln(2)/\alpha$ geeft ook voor grote dikte een aanzienlijke overschatting van de transmissie. Voor lood is de overschatting een factor 10, voor beton een factor 3. In de afschermberekeningen wordt deze benadering daarom niet gebruikt.



Tertiaire straling

Wanneer de secundaire straling op de muren, vloeren of het plafond valt, kan worden aangenomen dat een procent van de invallende straling verstrooid wordt [ref 1]. In de afschermberekening wordt de hoek van inval gelijk genomen aan de hoek van de uittreding. Ook voor tertiaire straling worden de halfwaardedikte parameters voor 150 kV uit tabel A.1 gebruikt [ref 2]. Deze aannname leidt tot een overschatting van de tertiaire straling.

De gezamenlijke bijdrage aan de tertiaire straling op enig punt via de vloer, het plafond en de muren, zijn kleiner dan een paar procent van de secundaire straling. De tertiaire straling is daarom niet meegenomen in de berekening.

Diagnostische CT-scanner

Hieronder de situatieschetsen en de berekening. Aanname is dat deze ruimte met lood afgeschermd zal worden. Met uitzondering van de afscherming richting de PET-CT ruimte (Punt F) is de benodigde afscherming rond of kleiner dan de typische waarde van 2 mm lood. De afscherming van de PET-ruimte zelf zal echter al ruim boven het equivalent van 2 mm lood liggen.

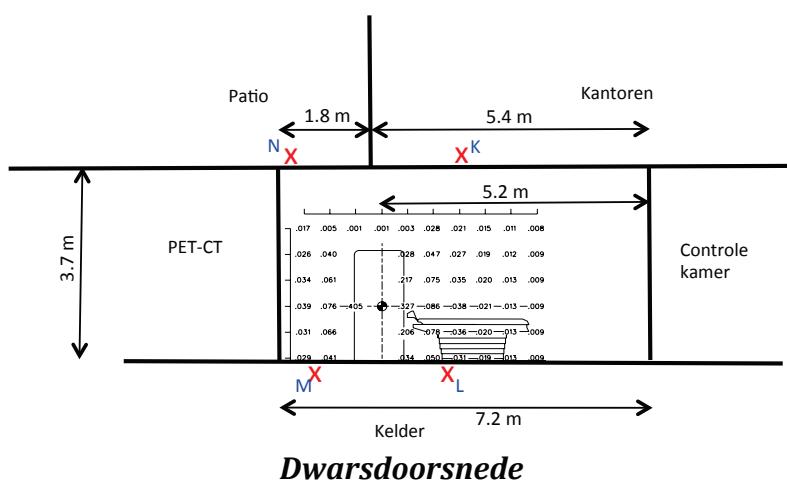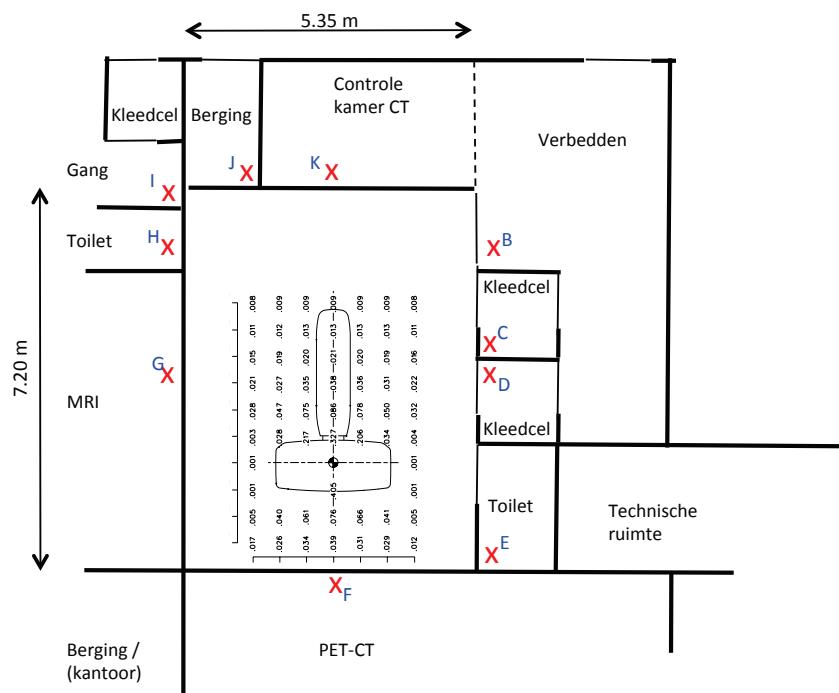

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|--|
| Hoogspanning | Referentie scan | Klinisch gebruik | De scan lengte komt overeen met de isodosen zoals door Philips aangeleverd |
| Scan lengte (typisch) | 140 | 125 kV 30.00 cm 250.00 mAs 16.00 per day 2.00 factor 0.30 fracie 5.00 factor 1.00 per seconde | |
| Stroomsterke | 2.4 | | |
| Aantal examinaties per dag | | | |
| Factor niet en zonder contrast | | | |
| Fractie 4D scans | | | |
| Belasting 4D versus 3D | | | |
| Aantal scanlengtes per seconde | | | |
| Aantal scan seconden per week | 4400 | 0.1 mSv | |
| Doelvoorschrift | | | |

dikte Lood (mm) = $1/(c\alpha^{\gamma})^{\frac{1}{\gamma}} \ln((transmissie^{\gamma} + \beta(c)) / (1 + \beta(c))) / 10$

dikte Beton (cm) = $1/(c\alpha^{\gamma})^{\frac{1}{\gamma}} \ln((transmissie^{\gamma} + \beta(c)) / (1 + \beta(c))) / 10$



| NCRP 147 | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|-----|-----|--------------------|
| Lood | 150 kV | 125 kV | Beton | x | y | afstand tot 'rand' |
| (m) | | | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 125 kV | 2.2190 | 0.0350 | 0.0324 | | | |
| | 7.9230 | 5.1770 | 0.0711 | | | |
| | 0.5366 | 0.3156 | 0.6874 | | | |
| | | | 4.4670 | | | |

Ervaring Radiologie van het LUMC: metingen wijzen uit dat de uitgangswaarden voor de berekeningen conservatief zijn gekozen
De gemeten dosis is richting de controlekamer slechts een kwart van de dosis waarmee werd gerekend (model)

| Locatie | Code | 'rand'waarde | x | y | afstand tot 'rand' | x | y | afstand tot meetpunt (m) | kwadratiewet factor | Dosis per mAs | Dosis @ "D5" mAs | Dosis per week (mSv) | Verblifsfactor | Transmissie, maximale toegestaan | 150 kV | Vereiste dikte Lood (mm) |
|-------------------|------|--------------|------|------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|--------|--------------------------|
| Controle kamer CT | A | 0.009 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 5.50 | 0.30 | 0.00268 | 0.67 | 2.945 | 1 | 0.001 | 2.2 | | |
| Verbedden | B | 0.016 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.00 | 0.25 | 0.00400 | 1.00 | 4.400 | 0.2 | 0.002 | 1.7 | | |
| Kleedcel | C | 0.032 | 1.5 | 0.9 | 2.50 | 2.9 | 1.6 | 3.31 | 0.28 | 0.00893 | 2.23 | 9.819 | 0.2 | 0.001 | 2.0 | |
| Kleedcel | D | 0.032 | 1.5 | 1.2 | 1.92 | 2.9 | 2.3 | 3.70 | 0.27 | 0.00862 | 2.15 | 9.481 | 0.2 | 0.001 | 2.0 | |
| Toilet | E | 0.005 | 1.5 | -0.9 | 1.75 | 3.0 | -1.8 | 3.50 | 0.25 | 0.00125 | 0.31 | 1.375 | 0.05 | 0.028 | 0.8 | |
| PET-CT | F | 0.039 | 0.0 | -1.5 | 1.50 | 0.0 | -2.4 | 3.40 | 0.39 | 0.01523 | 3.81 | 16.758 | 1 | 0.000 | 3.0 | |
| MRI | G | 0.028 | -1.5 | 0.8 | 1.70 | -3.1 | 1.6 | 3.49 | 0.24 | 0.00665 | 1.66 | 7.314 | 1 | 0.000 | 2.6 | |
| Toilet | H | 0.015 | -1.5 | 2.0 | 2.50 | -3.0 | 4.0 | 5.00 | 0.25 | 0.00375 | 0.94 | 4.125 | 0.05 | 0.009 | 1.1 | |
| Gang | I | 0.011 | -1.5 | 2.5 | 2.92 | -3.0 | 5.1 | 0.24 | 0.00267 | 0.67 | 2.938 | 0.2 | 0.003 | 1.5 | | |
| Beriging | J | 0.009 | -0.9 | 3.0 | 3.13 | -1.6 | 5.4 | 5.63 | 0.31 | 0.00278 | 0.70 | 3.062 | 0.2 | 0.003 | 1.5 | |
| Kantoren | K | 0.020 | 0.8 | 1.5 | 1.70 | 1.5 | 2.9 | 3.26 | 0.27 | 0.00542 | 1.36 | 5.964 | 1 | 0.000 | 2.5 | |
| Kelder | L | 0.050 | 1.0 | -1.0 | 1.41 | 1.3 | -1.3 | 1.84 | 0.59 | 0.02859 | 7.40 | 32.544 | 0.025 | 0.002 | 1.6 | |
| Kelder | M | 0.041 | -1.0 | -1.0 | 1.41 | -1.3 | -1.4 | 1.91 | 0.55 | 0.02247 | 5.62 | 24.712 | 0.025 | 0.003 | 1.5 | |
| Patio | N | 0.050 | -1.0 | 1.5 | 1.80 | -1.8 | 2.9 | 3.41 | 0.28 | 0.01395 | 3.49 | 15.343 | 0.2 | 0.001 | 2.2 | |

CT (behorende bij PET)

Hieronder de situatieschetsen en de berekening. Aanname is dat de PET-CT ruimte met Robaliet afgeschermd wordt. Voor het FDG gebruik zal de afscherming van deze ruimte minstens 6 cm Robaliet bedragen, wat equivalent is aan 6 mm lood. Op enkele plekken is de benodigde afscherming voor het CT-gebruik groter dan de typische waarde van 2 mm lood. Dit is ruim onder de aanwezige afscherming voor FDG gebruik waardoor de bijdrage van de CT aan de jaardosis buiten de ruimte minimaal is.

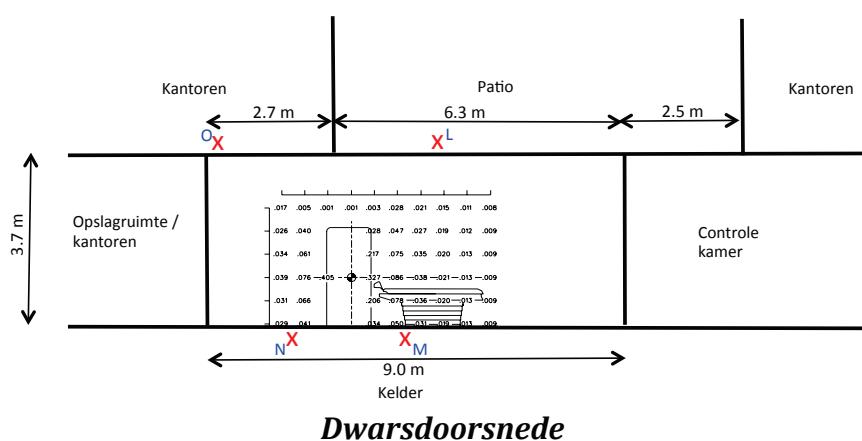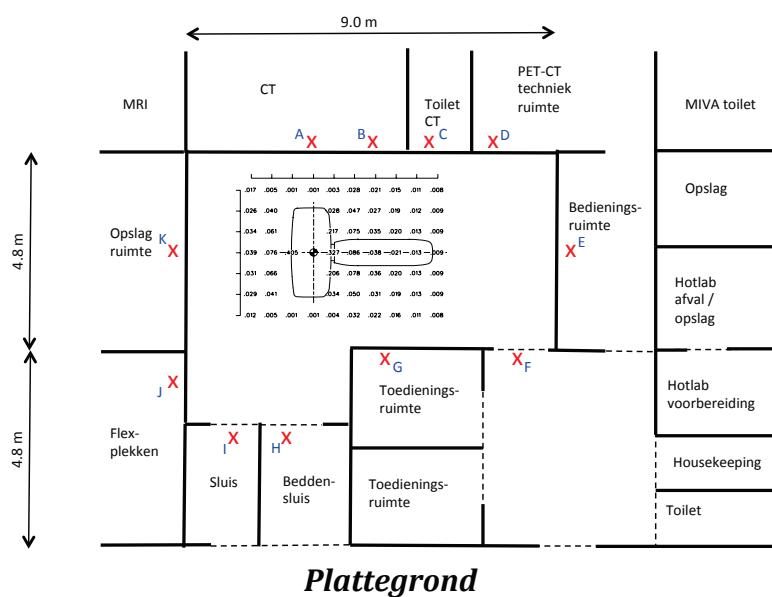

| | Referentie scan | Klinisch Gebruik | Die scan lengte komt overeen met de isodosen zoals door Philips aangeleverd |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| Hoogspanning | 140 | 125 | kV |
| Scan lengte (tipisch) | 2.4 | 30.00 | cm |
| Stroomsterkte | | 250.00 | mAs |
| Aantal examinaties per dag | | 16.00 | per day |
| Factor niet en zonder contrast | | 2.00 | factor |
| Fractie 4D scans | | 0.30 | fractie |
| Belasting 4D versus 3D | | 5.00 | factor |
| Aantal scanlengtes per seconde | | 1.00 | per seconde |
| Aantal scan seconden per week | 4400 | 0.1 | mSv |
| Doelvoorschrift | | | |

$$\text{dikte Lood (mm)} = \frac{1}{(\alpha\gamma)^*} \ln((\text{transmissie}^* + (\beta/\alpha)) / (1 + (\beta/\alpha))) / 10$$



| NCRP 47 | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---|---|
| Lood | 125 kV | 150 kV | Beton | x | y |
| 2.2190 | 1.7570 | 0.9350 | 0.0324 | | |
| 7.9230 | 5.1770 | 0.0711 | 0.0860 | | |
| 0.5336 | 0.3156 | 0.6874 | 4.4670 | | |

Ervaring Radiologie: metingen wijzen uit dat de uitgangswaarden voor de berekeningen conservatief zijn gekozen
De gemeten dosis is richting de controlekamer slechts een kwart van de dosis waar mee werd gerekend (model)

| Locatie | Code | 'rand'waarde | x | y | afstand tot 'rand' (m) | x | y | afstand tot meetpunt (m) | kwadratenwet factor | Dosis per minuut per mAs | Dosis @ "D5" mAs | Dosis per week (mSv) | Verblif- factor | Transmissie, maximaal toegestan- | Vereiste dikte Lood (mm) |
|---------------------------------|------|--------------|------|------|---------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| Diagnostische CT ruimte | A | 0.001 | 0.0 | 1.5 | 1.50 | 0.0 | 2.7 | 2.70 | 0.31 | 0.00031 | 0.340 | 1 | 0.006 | 1.3 | |
| Diagnostische CT ruimte | B | 0.028 | 0.9 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 2.7 | 3.09 | 0.32 | 0.00898 | 2.25 | 9.879 | 1 | 0.000 | 2.7 |
| Toilet | C | 0.018 | 1.8 | 1.5 | 2.34 | 2.8 | 2.7 | 3.89 | 0.36 | 0.00653 | 1.63 | 7.185 | 0.05 | 0.005 | 1.3 |
| Techniek ruimte PET-CT | D | 0.010 | 2.7 | 1.5 | 3.09 | 4.4 | 2.7 | 5.16 | 0.36 | 0.00358 | 0.89 | 3.938 | 0.025 | 0.020 | 0.9 |
| Bedieningsruimte | E | 0.009 | 3.0 | 0.0 | 3.00 | 0.0 | 6.3 | 6.30 | 0.23 | 0.00204 | 0.51 | 2.245 | 1 | 0.001 | 2.0 |
| Gang | F | 0.008 | 2.9 | -1.5 | 3.26 | 5.0 | -2.6 | 5.64 | 0.34 | 0.00269 | 0.67 | 2.954 | 0.2 | 0.003 | 1.5 |
| Toedieningsruimte | G | 0.023 | 1.2 | -1.5 | 1.92 | 1.8 | -2.6 | 3.16 | 0.37 | 0.00849 | 2.12 | 9.336 | 1 | 0.000 | 2.7 |
| Beddensluis | H | 0.001 | -0.3 | -1.5 | 1.53 | -0.7 | -4.5 | 4.55 | 0.11 | 0.00011 | 0.03 | 0.124 | 0.2 | 0.077 | 0.5 |
| Sluis | I | 0.002 | -0.8 | -1.5 | 1.70 | -2.0 | -4.5 | 4.92 | 0.12 | 0.0024 | 0.06 | 0.262 | 0.2 | 0.037 | 0.7 |
| Flex werkplek | J | 0.012 | -0.5 | -1.5 | 2.12 | -3.5 | -3.2 | 4.74 | 0.20 | 0.00240 | 0.60 | 2.641 | 1 | 0.001 | 2.1 |
| Opslagruimte toekomst werkplek) | K | 0.039 | -1.5 | 0.0 | 1.50 | -3.5 | 0.0 | 3.50 | 0.18 | 0.00716 | 1.79 | 7.880 | 1 | 0.000 | 2.6 |
| Patio | L | 0.028 | 1.5 | 0.7 | 1.66 | 2.0 | 3.0 | 3.61 | 0.21 | 0.00590 | 1.48 | 6.492 | 0.2 | 0.001 | 1.8 |
| Kelder | M | 0.050 | 0.9 | 1.0 | 1.36 | 1.2 | -1.4 | 1.84 | 0.53 | 0.02662 | 6.65 | 29.279 | 0.025 | 0.003 | 1.6 |
| Kelder | N | 0.041 | -1.0 | -1.0 | 1.41 | -1.3 | -1.4 | 1.91 | 0.55 | 0.02247 | 5.62 | 24.712 | 0.025 | 0.003 | 1.5 |
| Werkplekken | O | 0.017 | -1.4 | 1.5 | 2.05 | -3.1 | 3.0 | 4.31 | 0.23 | 0.00385 | 0.96 | 4.230 | 1 | 0.000 | 2.3 |

In-room CT's (beide gantries)

De gantry bunkers worden met beton afgeschermd. De benodigde afscherming in beton om aan de doellimiet van 0.1 mSv per jaar te voldoen is 26 cm en is daarmee veel lager dan de betondikte van de gantry bunkers. De minimum dikte hiervan is 150 cm (richting de oogbunker).

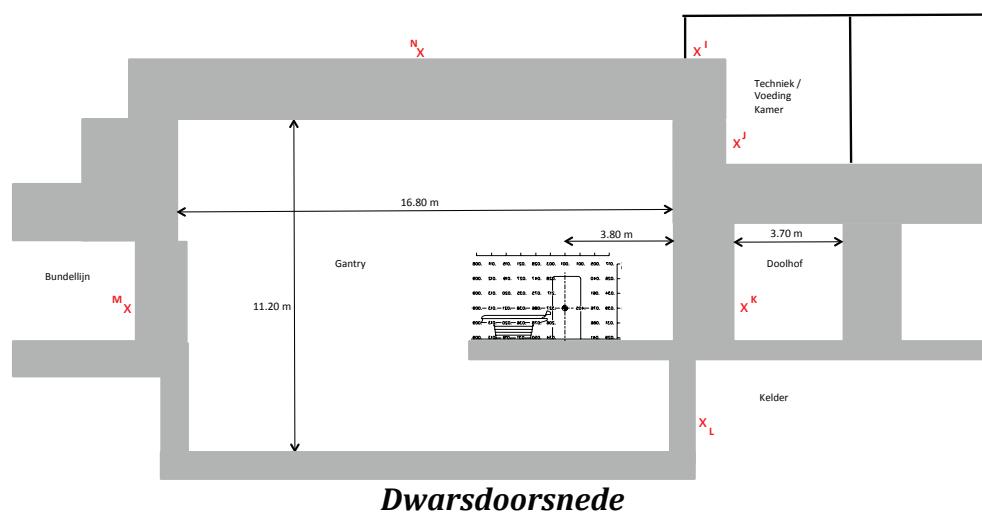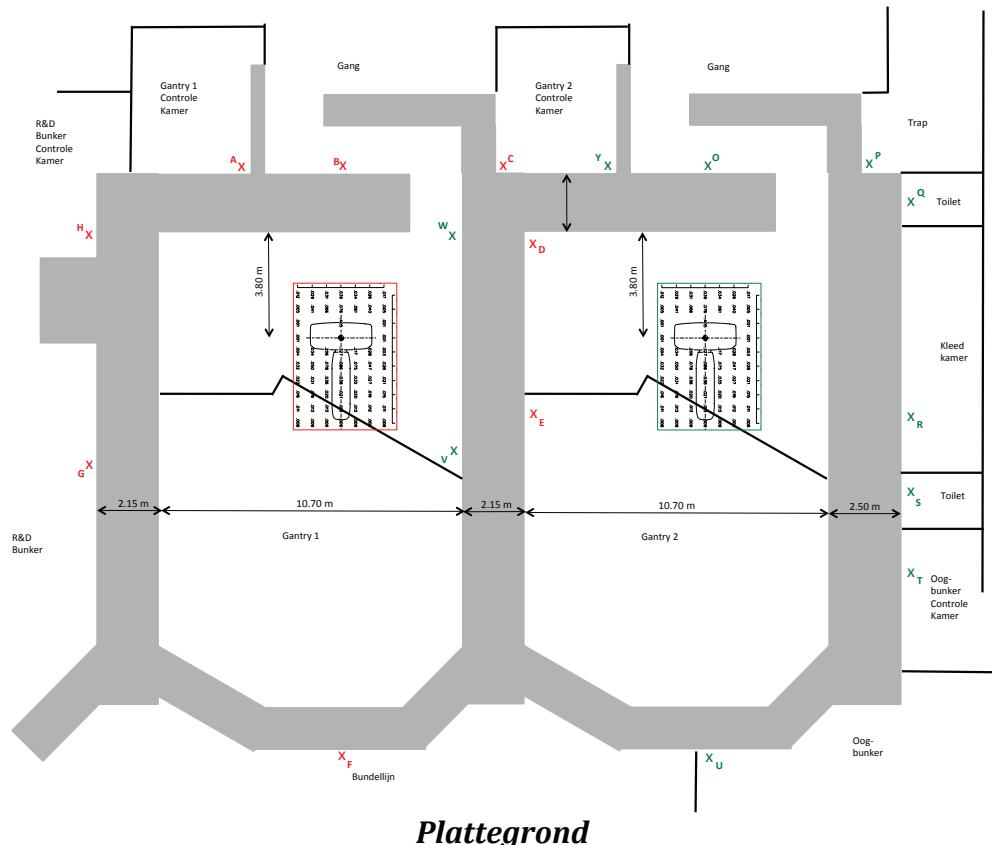

| | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|--|
| Hoogspanning | Klinisch scan | Klinisch Gebruik | De scan lengte komt overeen met de isodosen zoals door Philips aangeleverd |
| Scan lengte (typisch) | 125 cm | 125 cm | |
| Stroomsterkte | 30.00 mAs | 250.00 mAs | |
| Aantal examinaties per dag | 64.00 factor | 64.00 factor | |
| Factor niet en zonder contrast | 2.00 fractie | 0.30 fractie | |
| Fractie 4D scans | 0.30 factor | 5.00 factor | |
| Basislengte 4D versus 3D | 5.00 per second | 1.00 per second | |
| Aantal scanlengtes per seconde | | | |
| Doelevorschrijf | 21120 | 0.1 mSv | |

Aantal scan seconden per week

0.1

$$\text{dikte Lood (mm)} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\alpha + \gamma}{\gamma} \right) \ln \left(\frac{\text{transmissie}_1}{\text{transmissie}_2} \right) \left(\frac{1 + \beta/\alpha}{1 + \beta/\alpha} \right) / 10$$

$$\text{dikte Beton (cm)} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\alpha + \gamma}{\gamma} \right) \ln \left(\frac{\text{transmissie}_1}{\text{transmissie}_2} \right) \left(\frac{1 + \beta/\alpha}{1 + \beta/\alpha} \right) / 10$$

| NCRP 147 | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|-------|---|---|--------------------|---|---|
| Lood | 150 kV | 125 kV | 150 kV | Beton | x | y | afstand tot 'rand' | x | y |
| 2.2190 | 1.7570 | 0.0350 | 0.0324 | | | | | | |
| 7.9230 | 5.1770 | 0.0711 | 0.0860 | | | | | | |
| 0.5386 | 0.3156 | 0.6974 | 4.4670 | | | | | | |

Ervaring Radiologie: metingen wijzen uit dat de uitgangswaarden voor de berekeningen conservatief zijn gekozen
De gemelde dosis is richting de controlekamer slechts een kwart van de dosis waarmee werd gerekeend (model)

| Use | Code | 'rand'waarde | x | y | afstand tot 'rand' | x | y | afstand tot meetpunt (cm) | kwadratiewt factor | Dosis per mAs | Dosis @ "DS" mAs | Dosis per week (mSv) | Gebruiksfactor | maximaal toegestane | Transmissie, 150 kV | Vereiste dikte Beton (cm) |
|---------------------------|------|--------------|------|------|--------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Controle kamer Gantry 1 | A | 0.029 | -1.0 | 1.5 | 1.80 | -3.5 | 6.0 | 6.95 | 0.07 | 0.00195 | 0.49 | 10.314 | 1 | 0.000 | 25.6 | |
| Doolhof Gantry 1 | B | 0.039 | 0.0 | 1.5 | 1.50 | 0.0 | 6.1 | 6.10 | 0.06 | 0.00236 | 0.59 | 12.451 | 0.05 | 0.003 | 16.9 | |
| Controle kamer Gantry 2 | C | 0.017 | 1.5 | 1.5 | 2.12 | 5.7 | 6.0 | 8.28 | 0.07 | 0.00112 | 0.28 | 5.898 | 1 | 0.000 | 23.9 | |
| Gantry 2 bunker | D | 0.003 | 1.5 | 0.7 | 1.66 | 6.8 | 3.4 | 7.60 | 0.05 | 0.00014 | 0.04 | 0.751 | 1 | 0.003 | 17.5 | |
| Gantry 2 bunker | E | 0.015 | 1.5 | -0.7 | 1.66 | 6.8 | -2.7 | 7.32 | 0.05 | 0.00077 | 0.19 | 4.054 | 1 | 0.000 | 22.7 | |
| Bundellijn | F | 0.009 | 0.0 | -3.0 | 3.00 | 0.0 | -14.8 | 14.80 | 0.04 | 0.00037 | 0.09 | 1.953 | 0.025 | 0.039 | 9.1 | |
| R&D Bunker | G | 0.032 | -1.5 | -1.0 | 1.80 | -8.9 | -4.5 | 9.97 | 0.03 | 0.01015 | 0.26 | 5.521 | 1 | 0.000 | 23.7 | |
| Controle kamer R&D bunker | H | 0.003 | -1.5 | 0.7 | 1.66 | -8.9 | 3.5 | 9.56 | 0.03 | 0.00099 | 0.02 | 0.475 | 1 | 0.004 | 16.1 | |
| Techniekruimte | I | 0.022 | 0.8 | 1.5 | 1.70 | 4.4 | 8.7 | 9.75 | 0.03 | 0.00099 | 0.02 | 0.482 | 0.025 | 0.0160 | 4.8 | |
| J / J | J | 0.022 | 1.3 | 1.98 | 5.7 | 5.5 | 7.92 | 0.06 | 0.00138 | 0.35 | 7.295 | 0.025 | 0.011 | 13.2 | | |
| K / K | K | 0.039 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 6.0 | 0.0 | 6.00 | 0.06 | 0.00244 | 0.61 | 12.870 | 0.05 | 0.003 | 17.0 | |
| Keider | L | 0.038 | 1.2 | -1.0 | 1.56 | 4.6 | -3.8 | 5.97 | 0.07 | 0.00260 | 0.65 | 13.752 | 0.025 | 0.006 | 15.1 | |
| Bundellijn | M | 0.009 | -3.0 | 0.0 | 3.00 | -14.7 | 0.0 | 14.70 | 0.04 | 0.00037 | 0.09 | 1.979 | 0.025 | 0.039 | 9.1 | |
| Dak | N | 0.028 | -0.8 | 1.5 | 1.70 | -4.9 | 8.7 | 9.98 | 0.03 | 0.00881 | 0.20 | 4.285 | 0.025 | 0.018 | 11.5 | |
| Doolhof Gantry 2 | O | 0.039 | 0.0 | 1.5 | 1.50 | 0.0 | 6.0 | 6.00 | 0.06 | 0.00244 | 0.61 | 12.870 | 0.05 | 0.003 | 17.0 | |
| Trap | P | 0.017 | 1.5 | 2.12 | 5.7 | 6.0 | 8.28 | 0.07 | 0.00112 | 0.28 | 5.898 | 0.025 | 0.013 | 12.5 | | |
| Toilet | Q | 0.005 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | 7.2 | 4.8 | 8.65 | 0.04 | 0.00222 | 0.05 | 1.146 | 0.05 | 0.034 | 9.6 | |
| Kledekamer | R | 0.015 | 1.5 | -0.7 | 1.66 | 6.8 | -2.7 | 7.32 | 0.05 | 0.00077 | 0.19 | 4.054 | 0.2 | 0.002 | 17.8 | |
| Toilet | S | 0.026 | 1.5 | -1.2 | 1.92 | 7.3 | -5.5 | 9.14 | 0.04 | 0.00115 | 0.29 | 6.064 | 0.05 | 0.006 | 14.7 | |
| Controle kamer oogbunker | T | 0.018 | 1.5 | -1.7 | 2.27 | 7.3 | -8.3 | 11.05 | 0.04 | 0.00076 | 0.19 | 3.998 | 1 | 0.000 | 22.7 | |
| Oogbunker | U | 0.009 | 0.0 | -3.0 | 3.00 | 0.0 | -14.8 | 14.80 | 0.04 | 0.00037 | 0.09 | 1.953 | 1 | 0.001 | 20.5 | |
| Gantry 1 | V | 0.020 | -1.5 | -0.8 | 1.68 | -8.9 | -4.0 | 9.76 | 0.03 | 0.00059 | 0.15 | 3.119 | 1 | 0.001 | 21.9 | |
| Gantry 1 | W | 0.003 | 0.7 | 1.66 | -8.9 | 3.5 | 6.0 | 9.56 | 0.03 | 0.00099 | 0.02 | 0.475 | 1 | 0.004 | 16.1 | |
| Controle kamer Gantry 2 | Y | 0.029 | -1.0 | 1.5 | 1.80 | -3.5 | 6.0 | 6.95 | 0.07 | 0.00195 | 0.49 | 10.314 | 1 | 0.000 | 25.6 | |

Afschermingsberekeningen overige Röntgentoestellen

De overige Röntgentoestellen (6 stuks, maximale hoogspanning 150 kV) worden gebruikt voor orthogonale beeldvorming in de behandelbunkers (de twee gantries en de oogbunker), ten behoeve van positieverificatie van de patiënt in relatie tot de protonentherapie bundel(s). Verwacht gebruik op HollandPTC is 2-3 keer een set van orthogonale beelden per patient per fractie (van 25 minuten). Deze beelden worden van buiten de bestralingsbunker gemaakt. Typische afscherming van deze apparatuur (in een diagnostische setting) is een paar millimeter lood of het afschermingsequivalent daarvan aan beton. De benodigde afscherming is van vergelijkbare orde als voor afscherming van de in-room CT-scanners. De diktes van de bunkerwanden (typische waarden van 1.5 tot 2 meter) is vele malen groter. Voor deze Röntgentoestellen voor positieverificatie in de bunkers zijn dan ook geen aparte afschermingsberekeningen gedaan.

Referenties

- [1] *Radiation shielding for diagnostic X-rays*, report of joint BIR/IPEM working party, D. G. Sutton and J. R. Williams, British institute of radiology (2000).
- [2] NCRP Report 147: *Structural Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities* (2004).
- [3] AAPM report no. 96: *The measurement, reporting and management of radiation dose in CT*, report of AAPM task group 23 of the Diagnostic imaging council CT committee (2008).